

CTBT 高崎放射性核種観測所の粒子状放射性核種の観測結果 (2013年4月～)

公益財団法人 日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター

(CTBT 国内運用体制事務局)

2013年9月13日

1. はじめに

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性核種は、包括的核実験禁止条約（CTBT）の放射性核種観測網でも検出された（詳細は以下の URL を参照されたい：<http://www.cpdnp.jp/pdf/002-07-yone002.pdf>）。特に、事故を起こした原発に最も近い群馬県高崎市にある観測所では高濃度の放射性核種が検出された。このことから、当センターでは CTBT の国内当局である外務省の許可を得て、高崎観測所の粒子状放射性核種の測定結果を事故直後からホームページ上に掲載し、高崎における空気中の放射能濃度を公表してきた。事故直後は数多くの人工放射性核種が検出されたが、事故後約2年経過した現在では長寿命の¹³⁴Cs（セシウム-134）と¹³⁷Cs（セシウム-137）が検出されるのみとなっている。

現在検出される¹³⁴Cs と¹³⁷Cs の大部分は、事故直後観測所に到達した高濃度の放射性プルームによって汚染されたもので、これまで装置の除染（2011年8月）が行われ、検出器の遮へい体の一部が交換（2012年4月）、残りの遮へい体と検出器も交換された（2013年1月、詳細は第3.3節参照）が、依然として装置又は建屋には汚染が残っている。今後もこれらの核種の汚染量の低減化が試みられる予定である。測定装置はこのような状況にあるが、原発事故による放射性核種観測が引き続き重要である現状に鑑み、高崎観測所の粒子状放射性核種の観測データを今後もホームページ上に掲載する。2012年3月までは、事故によって放出された人工放射性核種の測定データだけを掲載していたが、現在検出される人工放射性核種が¹³⁴Cs と¹³⁷Cs のみとなり、それらの放射能濃度も天然放射性核種のものよりも低くなっている。このため、2012年4月以降は、これまで公表したデータとの整合性を取るため、事故後に検出された代表的な人工放射性核種と天然放射性核種の放射能濃度を掲載している。ただし、¹³⁴Cs と¹³⁷Cs 以外の人工放射性核種は、現在検出されないため、それらの最低検出可能放射能濃度（MDC）を示した。これにより、事故によって放出された人工放射性核種と自然界に常時存在する天然放射性核種濃度の比較も可能になる。

2. CTBT の放射性核種観測

現在、包括的核実験禁止条約（CTBT）の発効に向け、核爆発を監視する検証制度の整備が地球規模で進められている。核爆発は、地震波、微気圧振動、水中音波などの測定、そして核爆発によって生成する放射性核種の放射能測定によって検知することができる。このため、核爆発の科学的な検証は国際監視制度（IMS）による地震波等の物理的観測と放射性核種観測、そして現地に行って調査をする現地査察（OSI）によって行われる。IMS の監視施設としては、地震波（170箇所）、微気圧振動（60箇所）、水中音波（11箇所）、そして放射性核種（80箇所）の観測所の設置が条約で決められており（放射性核種の公認実験施設を含めれば89箇所、337箇所）、これまでにそれらの約85%の施設が完成し、条約が発効するまで暫定的に運用されている。核爆発の事象は、地震波の波形観測によって検知することができるが、それだけでは化学爆発と区別することが難しく、これを核実験と断定するには核爆発由来の放射性核種の検出に頼らなければならない。

放射性核種の観測は、大気中の粒子状放射性核種と放射性キセノンを対象に行われる。これらの観測所は、全地球をカバーするように80箇所配置されており、全ての観測所には粒子状放射性核種

測定装置が、そして半分の40箇所の観測所には放射性キセノンの測定装置が設置されることになっている。これまでに65箇所の粒子観測所と、31箇所の放射性キセノン観測所が完成し（2012年6月現在）、条約が発効するまでの間暫定的に運用されている。我が国には、群馬県高崎市と沖縄県恩納村に放射性核種観測所があり、高崎観測所には粒子状放射性核種測定装置と放射性キセノン測定装置が、そして沖縄観測所には粒子状放射性核種測定装置が設置され、運用されている。

核爆発を確実に検知するために監視対象放射性核種が決められている。これらの監視対象核種は、爆発によって生成した放射性核種が検出されるまでの移動時間を3日間と仮定し、それ以降に存在する可能性が高い半減期が6時間から1000年の核種で、かつ測定が容易な γ 線を放出する放射性核種が選ばれている。IMSの監視対象放射性核種とそれらの半減期を表1に示す。監視対象核種には、核分裂生成物46核種と放射化生成物42核種が選定されている。これらの放射性核種のうち、放射性キセノン（ ^{131m}Xe , ^{133m}Xe , ^{133}Xe , ^{135}Xe ）は希ガス測定装置で測定され、それ以外の核種は粒子状放射性核種測定装置で測定される。

表1 CTBTの監視対象放射性核種

核分裂生成物 (46核種)			放射化生成物 (42核種)		
核種		半減期	核種		半減期
⁹¹ Sr	(ストロンチウム-91)	9.63 時間	²⁴ Na	(ナトリウム-24)	14.96 時間
⁹¹ Y	(イットリウム-91)	58.51 日	⁴² K	(カリウム-42)	12.36 時間
⁹³ Y	(イットリウム-93)	10.18時間	⁴⁶ Sc	(スカンジウム-46)	83.79 日
⁹⁵ Zr	(ジルコニウム-95)	64.02 日	⁴⁷ Sc	(スカンジウム-47)	3.349 日
⁹⁵ Nb	(ニオブ-95)	34.98 日	⁵¹ Cr	(クロム-51)	27.70 日
⁹⁷ Zr	(ジルコニウム-97)	16.91時間	⁵⁴ Mn	(マンガン-54)	312.1 日
⁹⁹ Mo	(モリブデン-99)	65.94時間	⁵⁷ Co	(コバルト-57)	271.8 日
^{99m} Tc	(テクネチウム-99m)	6.01時間	⁵⁸ Co	(コバルト-58)	70.82 日
¹⁰³ Ru	(ルテニウム-103)	39.26 日	⁵⁹ Fe	(鉄-57)	44.50 日
¹⁰⁵ Rh	(ロジウム-105)	35.36時間	⁶⁰ Co	(コバルト-60)	5.271 年
¹⁰⁶ Ru	(ルテニウム-106)	373.59 日	⁶⁵ Zn	(亜鉛-65)	244.3 日
¹¹¹ Ag	(銀-111)	7.45 日	^{69m} Zn	(亜鉛-69m)	13.76 時間
¹¹² Pd	(パラジウム-112)	21.03 時間	⁷² Ga	(ガリウム-72)	14.1 時間
^{115m} Cd	(カドミウム-115m)	44.6 日	⁷⁴ As	(ヒ素-74)	17.77 日
¹¹⁵ Cd	(カドミウム-115)	53.46 時間	⁷⁶ As	(ヒ素-76)	1.078 日
¹²⁵ Sn	(錫-125)	9.64 日	⁸⁴ Rb	(ルビジウム-84)	32.77 日
¹²⁵ Sb	(アンチモン-125)	2.76 年	⁸⁶ Rb	(ルビジウム-86)	18.68 日
¹²⁶ Sb	(アンチモン-126)	12.46 日	⁸⁸ Y	(イットリウム-88)	106.7 日
¹²⁷ Sb	(アンチモン-127)	3.85 日	⁸⁹ Zr	(ジルコニウム-89)	78.41 時間
¹²⁸ Sb	(アンチモン-128)	9.01 時間	¹⁰² Rh	(ロジウム-102)	207 日
^{129m} Te	(テルル-129m)	33.6 日	^{106m} Ag	(銀-106m)	8.28 日
¹³⁰ I	(ヨウ素-130)	12.36 時間	^{108m} Ag	(銀-108m)	418 年
^{131m} Te	(テルル-131m)	30 時間	^{110m} Ag	(銀-110m)	249.8 日
¹³¹ I	(ヨウ素-131)	8.02 日	¹²⁰ Sb	(アンチモン-120)	5.76 日
¹³² Te	(テルル-132)	3.20 日	¹²² Sb	(アンチモン-122)	2.724 日
¹³³ I	(ヨウ素-133)	20.8 時間	¹²⁴ Sb	(アンチモン-124)	60.20 日
¹³⁵ I	(ヨウ素-135)	6.57 時間	¹³² Cs	(セシウム-132)	6.479 日
^{131m} Xe	(キセノン-131m)	11.84 日	¹³³ Ba	(バリウム-133)	10.52 年
^{133m} Xe	(キセノン-133m)	2.19 日	¹³⁴ Cs	(セシウム-134)	2.065 年
¹³³ Xe	(キセノン-133)	5.243 日	^{152m} Eu	(ユウロピウム-152m)	9.312 時間
¹³⁵ Xe	(キセノン-135)	9.14 時間	¹⁵² Eu	(ユウロピウム-152)	13.54 年
¹³⁶ Cs	(セシウム-136)	13.16 日	¹⁶⁸ Tm	(ツリウム-168)	93.1 日
¹³⁷ Cs	(セシウム-137)	30.07 年	¹⁸⁷ W	(タングステン-187)	23.72 時間
¹⁴⁰ Ba	(バリウム-140)	12.75 日	¹⁹⁰ Ir	(イリジウム-190)	11.78 日
¹⁴⁰ La	(ランタン-140)	1.678 日	¹⁹² Ir	(イリジウム-192)	73.83日
¹⁴¹ Ce	(セリウム-141)	32.50 日	¹⁹⁶ Au	(金-196)	6.183 日
¹⁴³ Ce	(セリウム-143)	33.04 時間	^{196m} Au	(金-196m)	9.7 時間
¹⁴⁴ Ce	(セリウム-144)	284.9 日	¹⁹⁸ Au	(金-198)	2.695 日
¹⁴⁷ Nd	(ネオジウム-147)	10.98 日	²⁰³ Pb	(鉛-203)	51.87 時間
¹⁴⁹ Pm	(プロメチウム-149)	53.08 時間	²²⁴ Ra	(ラジウム-224)	3.66 日
¹⁵¹ Pm	(プロメチウム-151)	28.40 時間	²³⁷ U	(ウラン-237)	6.75 日
¹⁵³ Sm	(サマリウム-153)	46.27 時間	²³⁹ Np	(ネプツニウム-239)	2.357 日
¹⁵⁵ Eu	(ユウロピウム-155)	4.761 年			
¹⁵⁶ Sm	(サマリウム-156)	9.4 時間			
¹⁵⁶ Eu	(ユウロピウム-156)	15.19 日			
¹⁵⁷ Eu	(ユウロピウム-157)	15.18 時間			

2. 高崎観測所における粒子状放射性核種測定

高崎観測所は、(独)日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所内に設置されている。高崎観測所の粒子状放射性核種自動測定装置 (RASA) による測定の概要と写真を図1と図2に示す。

ブローアーによって24時間集めた大気試料 (20000–25000 m³) を連続的にポリプロピレン樹脂製のフィルターに通過させ、粒子状放射性核種を捕集する。粒子を捕集後、フィルター面を移動させ、新しいフィルター面で翌日の試料を捕集する。新しい面で捕集を行っている間、前日に捕集された試料は、そこに含まれるウラン及びトリウム系列の短寿命天然放射性核種の放射能を減衰させるため、24時間冷却する。冷却後、粒子を捕集したフィルター面を鉛製遮へい体中のゲルマニウム半導体検出器に巻きつけ、24時間ガンマ線を測定する。測定終了後、測定データは直ちに衛星回線でオーストリアのウイーンにある CTBT 機関 (CTBTO) の国際データセンター (IDC) に専用の衛星回線で自動送信される。試料の捕集に24時間、冷却に24時間、ガンマ線測定に24時間かけるため、試料の捕集から72時間後に測定データが得られる。この間新しいフィルター面での試料捕集と、前日に捕集したフィルター面の冷却が同時並行して行われる。測定が終了したフィルターは、再測定が必要になった時のため、ポリエチレンシートに封入して保管される。測定データは、IDC で直ちにコンピュータによる自動解析と専門家による詳細解析が行われ、解析結果は条約締約国の認可された専門家だけがアクセスすることが出来る専用ウェブサイト上に公開される。

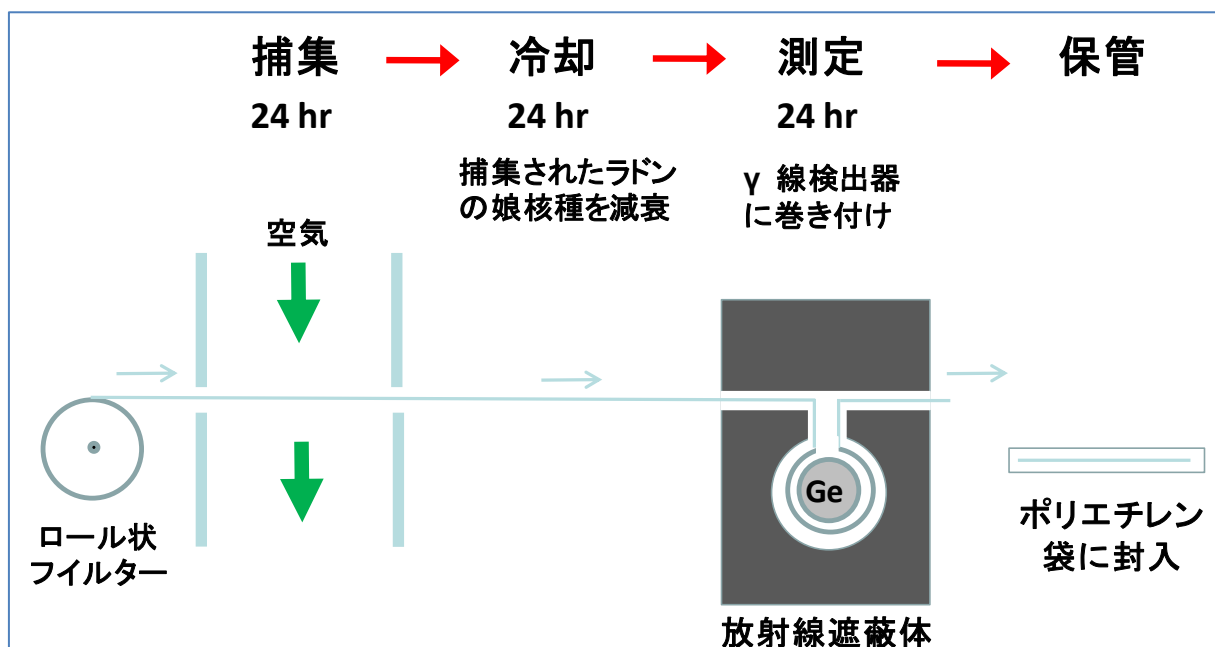


図1 粒子状放射性核種測定の概略図




図2 高崎観測所の粒子状放射性核種測定装置 (RASA) の写真

3. 測定結果

3.1 ガンマ線スペクトル

原発事故前と事故後の最近に測定された試料のガンマ線スペクトルを図3に示す。スペクトル(a)と(b)をそのままプロットすると、両方のスペクトルが重なって分かりにくくなるので、スペクトル(a)は1000倍してプロットしてある。

事故前のスペクトル (a) からは、自然界に常時存在する天然放射性核種のみが検出され、人工放射性核種は検出されない。検出される天然放射性核種は、宇宙線起源核種の ${}^7\text{Be}$ (ベリリウム-7)、原始放射性核種の ${}^{40}\text{K}$ (カリウム-40)、ウラン系列核種の ${}^{214}\text{Pb}$ (鉛-214)、 ${}^{214}\text{Bi}$ (ビスマス-214)、 ${}^{226}\text{Ra}$ (ラジウム-226)、 ${}^{234\text{m}}\text{Pa}$ (プロトアクチニウム-234m)、トリウム系列核種の ${}^{208}\text{Tl}$ (タリウム-208)、 ${}^{212}\text{Pb}$ (鉛-212)、 ${}^{212}\text{Bi}$ (ビスマス-212)、 ${}^{228}\text{Ac}$ (アクチニウム-228)、そしてアクチニウム系列核種の ${}^{235}\text{U}$ (ウラン-235) である。参考までに検出される天然放射性核種の壊変データを表2に示す。

2012年5月5日-6日に捕集された試料のガンマ線スペクトルを図3(b)に示す。原発事故直後には多数の人工放射性核種 (${}^{131,132,133}\text{I}$, ${}^{134,136,137}\text{Cs}$, ${}^{129,129\text{m},132}\text{Te}$, ${}^{140}\text{Ba}$ - ${}^{140}\text{La}$, ${}^{99}\text{Mo}$ - ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$, ${}^{95}\text{Nb}$) が検出されたが、2011年9月以降は ${}^{134}\text{Cs}$ (セシウム-134) と ${}^{137}\text{Cs}$ (セシウム-137) だけになっている。

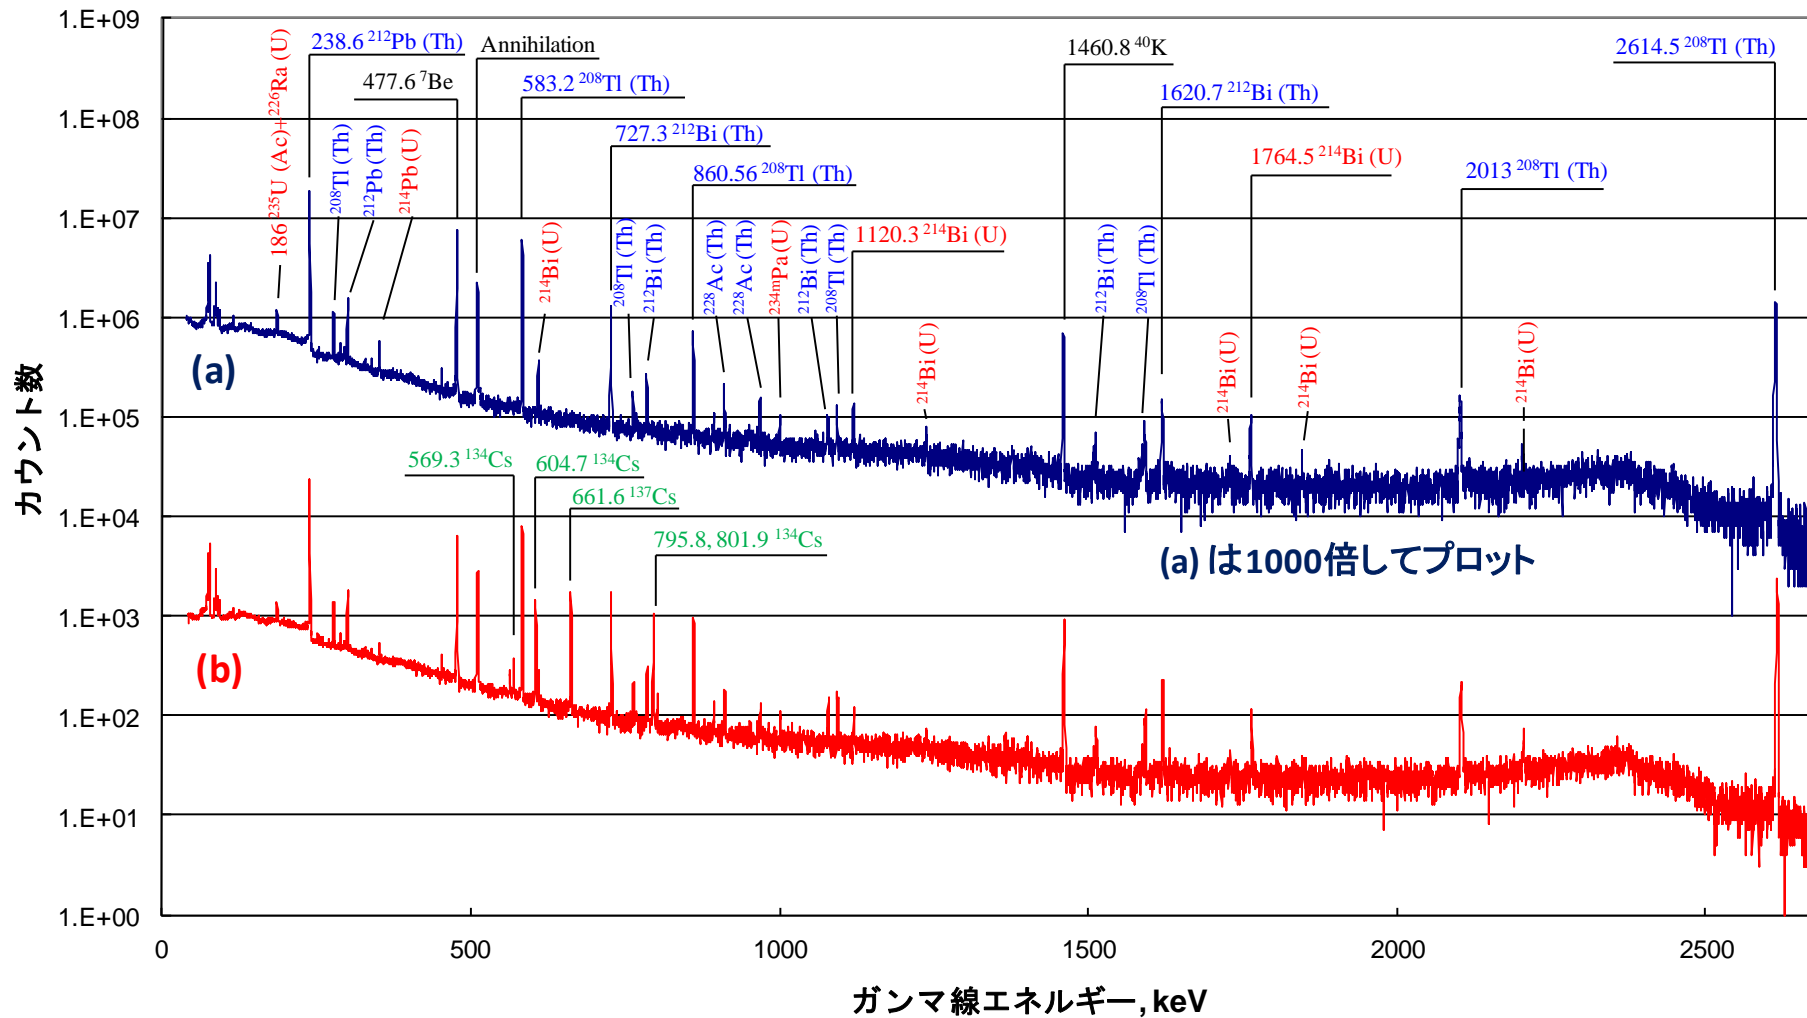


図3 粒子状放射性核種のガンマ線スペクトル

(a) : 原発事故前の2011年3月6日－7日に捕集された試料，スペクトル(b)との重なりを避けるため1000倍してプロットされている。

(b) : 原発事故後の2012年5月5日－6日に捕集された試料，原発事故によって放出された ^{134}Cs と ^{137}Cs が検出されている。

図中の数字はガンマ線エネルギー値 (keV) を表す。緑：人工放射性核種，紺：トリウム系列核種，赤：ウラン系列核種，黒：その他。

表2 高崎観測所の粒子状放射性核種測定装置で検出される天然放射性核種

核種	種類	半減期	主な γ 線エネルギー keV (放出率%)
^7Be	宇宙線起源核種 ¹⁾	53.12日	477.5(10.52)
^{40}K	原始放射性核種 ²⁾	1.277×10^9 年	1460.8(11)
^{228}Ac	トリウム系列 ³⁾	6.15時間	911.2(25.8), 968.9(15.8), 338.3(11.27)
^{212}Pb	同上	10.64時間	238.6(43.3), 300.0(3.28)
^{212}Bi	同上	60.55分	727.3(6.58), 1620.5(1.49), 785.3(1.102)
^{208}Tl	同上	6.053分	2614.5(99), 583.1(84.5), 860.5(12.42)
$^{234\text{m}}\text{Pa}$	ウラン系列 ⁴⁾	1.17分	1001.0(0.837), 766.3(0.294)
^{226}Ra	同上	1600年	186.2(3.59)
^{214}Pb	同上	26.8分	351.9(37.6), 295.2(19.3), 241.9(7.43)
^{214}Bi	同上	19.9分	609.3(46.1), 1764.4(15.4), 1120.2(15.1)
^{235}U	アクチニウム系列 ⁵⁾	7.038×10^8 年	185.7(57.2), 143.7(10.96)

- 1) 宇宙線に含まれる高エネルギー陽子と大気成分元素（炭素、窒素、酸素）の原子核との破砕反応によって生成される放射性核種。
- 2) 地球の誕生時から地殻中に存在してきた放射性核種。
- 3) 壊変が ^{232}Th （トリウム-232）から始まり、 ^{208}Pb （鉛-208）で終わる11種類の放射性核種から成る壊変系列。
- 4) 壊変が ^{238}U （ウラン-238）から始まり、 ^{206}Pb （鉛-206）で終わる18種類の放射性核種から成る壊変系列。
- 5) 壊変が ^{235}U （ウラン-235）から始まり、 ^{207}Pb （鉛-207）で終わる16種類の放射性核種から成る壊変系列。

3.2 最低検出可能放射能濃度 (MDC) の求め方

CTBT では、測定されるガンマ線スペクトル中の各 γ 線ピークの検出限界から、測定する核種の最低検出可能放射能 (MDA) と最低検出可能放射能濃度 (MDC) を求め、解析レポート RRR に示している。ここに、それらの求め方を示す。

まず、ガンマ線スペクトル中の注目するピークの検出下限 (L_d) は次式によって計算される。

$$L_d = 2.71 + 4.65\sqrt{N_B} \quad (1)$$

ここで、 N_B は注目するガンマ線ピーク領域のバックグラウンド計数値である。

次に、ピークの検出限界 (L_d) から測定した試料中の最低検出可能放射能 (MDA) を次式によって計算する。

$$\text{MDA}(\text{Bq}) = \frac{L_d}{t_l \cdot \epsilon_i \cdot \gamma_i \cdot K_c} \quad (2)$$

ここで、 t_l はガンマ線スペクトル測定のライブタイム、 ϵ はガンマ線の検出効率、 γ_i はガンマ線放出率、 K_c は測定期間中における放射性核種の壊変補正係数、 λ_i は測定する放射性核種の壊変定数である。

最後に、捕集した空気試料中の最低検出可能放射能濃度 (MDC) を次式から計算する。

$$\text{MDC}(\text{Bq}/\text{m}^3) = \frac{\text{MDA}}{V_0 \cdot \xi_i \cdot K_w \cdot K_s} \quad (3)$$

ここで、 V_0 は標準温度 (273.15K)、標準気圧 (101.325 Pa) 下に於ける採取した空気の容積 (m^3)、 ξ_i は測定する放射性核種の捕集効率 (%), K_s は試料捕集時間中における放射性核種の壊変補正係数、 K_w は捕集の終了と測定開始間における測定核種の壊変補正係数である。

高崎の粒子状測定装置による代表的な監視対象核種の MDC を表3に示す。上記の計算方法に示すように、MDC は測定条件や、共存する放射性核種の種類とその濃度、そして空気の捕集量等に影響される。原発事故前の2011年3月に捕集された7試料中の MDC の平均とその標準偏差を示す。ここに示す MDC は、これらの核種検出の目安となる。

表3 主な監視対象核種の最低検出可能放射能濃度 ($\mu\text{Bq}/\text{m}^3$)

核種	平均*	標準偏差*
^{95}Zr (ジルコニウム-95)	4.7	0.3
^{97}Zr (ジルコニウム-97)	16	1
^{95}Nb (ニオブ-95)	2.9	0.3
^{99}Mo (モリブデン-99)	32	2
^{103}Ru (ルテニウム-103)	2.8	0.2
^{132}Te (テルル-132)	5.4	0.6
^{131}I (ヨウ素-131)	4.0	0.4
^{133}I (ヨウ素-133)	13	1
^{134}Cs (セシウム-134)	2.6	0.1
^{136}Cs (セシウム-136)	2.8	0.1
^{137}Cs (セシウム-137)	2.9	0.2
^{140}Ba (バリウム-140)	11	0.7
^{143}Ce (セリウム-143)	17	2

* 原発事故以前 (2011年3月) に捕集された7試料の平均 MDC とその標準偏差

3.3 検出器遮へい体と検出器の交換

高崎観測所の粒子状放射性核種測定装置は福島原発事故で放出された放射性核種で汚染されたため、これまでに除染(2011年8月)と検出器遮へい体の一部の交換(2012年4月)が行われたが、依然として ^{134}Cs と ^{137}Cs の汚染が残されていた。このため、2013年1月11日から24日までの間装置を停止させ、未交換の遮へい体と検出器を新しいものに交換した。交換後検出器に試料を捕集していない新しいフィルターを取り付け、7日間測定して得られたブランク試料の γ 線スペクトルを図4に示す。ブランク試料からは依然として ^{134}Cs と ^{137}Cs のピークが観察された。遮へい体と検出器交換前後のブランク試料中の ^{134}Cs と ^{137}Cs の放射能を表4に示す。遮へい体と検出器を交換した効果は低く、これらの核種の γ 線計数は、遮へい体と検出器以外に付着した ^{134}Cs と ^{137}Cs によるものと考えられる。

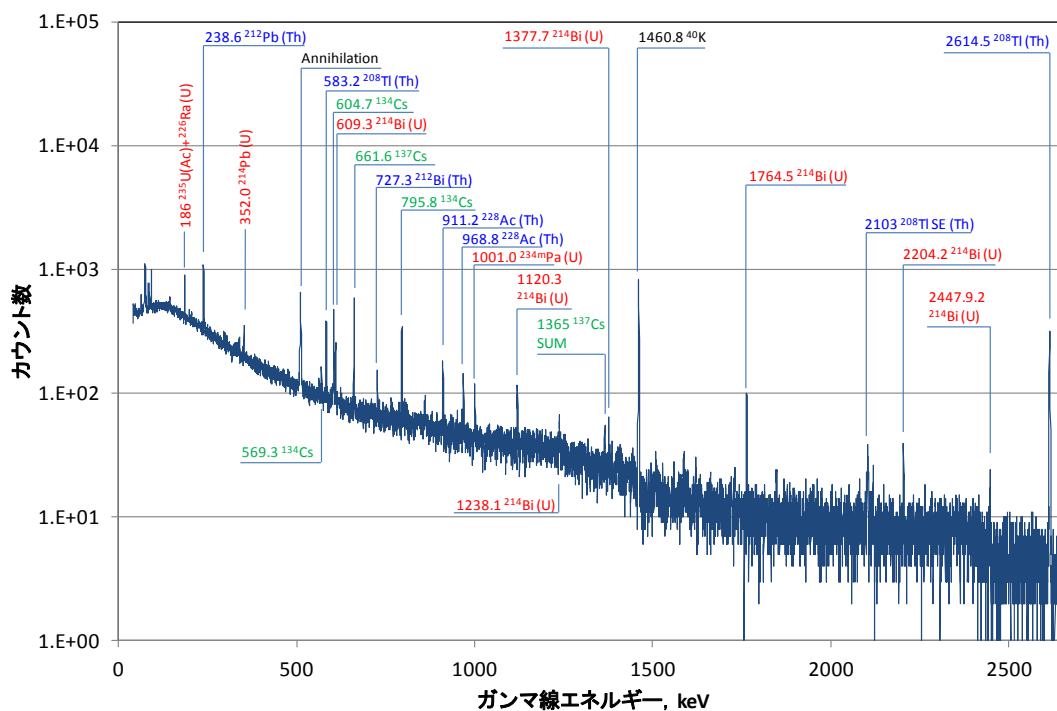


図4 検出器遮へい体と検出器を交換後のブランク試料の γ 線スペクトル

検出器遮へい体の一部と検出器を新しいものに交換後、試料を捕集していないフィルターを検出器に取り付け、7日間(604800秒間)測定して得られた γ 線スペクトル。依然として緑色で示す ^{134}Cs と ^{137}Cs のピークが検出されている。

表4 遮へい体と検出器を交換前後のブランク試料中の¹³⁴Csと¹³⁷Csの放射能

ブランク測定	¹³⁴ Csの放射能	¹³⁷ Csの放射能	減少率
2012年5月22日	0.78±0.03 Bq	1.18±0.05 Bq	1/1.5
2013年1月17日	0.48±0.01 Bq	0.81±0.03 Bq	1/1.7

3.4 放射性核種の放射能濃度

IDCが専用のウェブサイト上に報告する詳細解析レポート RRR から抽出した高崎観測所の粒子状放射性核種濃度を表5に示す。RRR は配信までに数日間かかるが信頼性が高いので、本資料ではこれを使用した。

現在検出される人工放射性核種は、¹³⁴Cs (セシウム-134) と¹³⁷Cs (セシウム-137) だけであるが、これまで公開したデータとの整合性から、事故直後に検出された代表的な人工放射性核種の¹³¹I (ヨウ素-131) , ¹³²Te (テルル-132) , ¹⁴⁰Ba (バリウム-140) の測定データも示す。これらの人工放射性核種は、検出された場合にはその濃度を、検出されない場合には ND (非検出) と表示し、測定期間内における最低検出可能放射能濃度の最高値と最低値も示す。

天然放射性核種としては、濃度が高い⁷Be (ベリリウム-7) , ⁴⁰K (カリウム-40) , そしてトリウム系列とウラン系列の代表的な核種の濃度を掲載する。トリウム系列の核種は²²⁸Ac (アクチニウム-228) と²¹²Pb (鉛-212) の濃度を、ウラン系列の核種は^{234m}Pa (プロトアクチニウム-234m) と²¹⁴Pb (鉛-214) の濃度を示す。²¹²Pb (鉛-212) と²¹⁴Pb (鉛-214) は、トリウム系列とウラン系列の希ガスの放射性核種²²⁰Rn と²²²Rn の壊変生成核種で、種々の自然科学現象の指標として有用である。また、アクチニウム系列の²³⁵U (ウラン-235) とウラン系列の²²⁶Ra (ラジウム-226) から放出される186 keV のピークも検出されるが、両核種のガンマ線エネルギー値が185.7 keV(²³⁵U)と186.2 keV(²²⁶Ra)と接近しているため、それらのガンマ線ピークを分離することが出来ない。さらに、186 keV ピークの計数も小さいことから、表にはこれらの核種濃度を載せない。

放射能壊変には統計的な変動が伴うので、計数値の大きさによって測定される値の変動幅が異なる。このため、測定されたガンマ線ピークの計数値から求められた統計学的変動幅を不確かさとして表示した。表には、この計数値から計算された放射能濃度の相対不確かさ(%)を示す。

表5 高崎観測所の粒子状放射性核種濃度
2013年4月

大気捕集時刻		CTBT監視対象放射性核種										天然放射性核種										
		I-131		Te-132		Cs-134		Cs-137		Ba-140	Be-7		K-40		Ac-228		Pb-212		Pa-234m		Bi-214	
		MDC	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ
開始	終了	μBq/m ³	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)
4月1日	4月2日	ND	ND	36	3	69	2	ND	6466	1	1087	2	56	6	85181	1	1387	9	22	9		
4月2日	4月3日	ND	ND	28	4	53	2	ND	764	2	1095	2	50	6	20836	1	1421	8	30	6		
4月3日	4月4日	ND	ND	32	3	60	2	ND	2475	1	1114	2	45	6	12598	1	1569	7	26	7		
4月4日	4月5日	ND	ND	54	3	99	2	ND	5688	1	1133	2	49	6	37044	1	1441	8	24	8		
4月5日	4月6日	ND	ND	165	2	305	1	ND	6717	1	1155	2	51	6	39130	1	1387	8	24	8		
4月6日	4月7日	ND	ND	24	4	47	3	ND	1916	1	1133	2	49	6	11223	1	1316	9	28	6		
4月7日	4月8日	ND	ND	48	3	88	2	ND	6180	1	1266	2	58	5	7357	1	1420	8	26	7		
4月8日	4月9日	ND	ND	47	3	89	2	ND	11661	1	1138	2	52	6	40100	1	1379	8	30	6		
4月9日	4月10日	ND	ND	9	15	65	2	ND	8244	1	1103	2	53	6	18595	1	1450	8	7	27		
4月10日	4月11日	ND	ND	104	2	203	1	ND	3668	1	1115	2	45	6	13234	1	1380	8	30	6		
4月11日	4月12日	ND	ND	26	4	49	2	ND	6126	1	1105	2	51	6	24299	1	1611	7	28	7		
4月12日	4月13日	ND	ND	26	4	48	3	ND	2590	1	1109	2	50	6	19281	1	1347	8	29	6		
4月13日	4月14日	ND	ND	38	3	78	2	ND	2967	1	1100	2	53	6	50343	1	1511	8	30	6		
4月14日	4月15日	ND	ND	39	3	74	2	ND	4906	1	1168	2	47	7	59736	1	1392	8	30	7		
4月18日	4月19日	ND	ND	133	2	250	1	ND	5168	1	1183	2	52	6	26279	1	1235	9	31	6		
4月22日	4月23日	ND	ND	33	3	63	2	ND	5636	1	1121	2	56	5	35725	1	1641	7	28	7		
MDC最低値		4	5					12														
MDC最高値		6	8					17														
平均				53		102			5073		1133		51		31310		1430		26			
標準偏差				43		78			2696		45		4		20669		107		6			

注1): NDは“非検出”を表す。

注2): 核種の選定は、第3.3項の説明参照

注3): 4月15-18日、4月19-22日、4月23日-5月1日の試料は、装置の不具合により解析データ (RRR) が発表されていない。

5月

大気捕集時刻		CTBT監視対象放射性核種							天然放射性核種													
		I-131		Te-132		Cs-134		Cs-137		Ba-140	Be-7		K-40		Ac-228		Pb-212		Pa-234m		Bi-214	
開始	終了	MDC	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ
		μBq/m ³	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)
5月1日	5月2日	ND	ND	59	2	116	2	ND	373	3	1121	2	48	6	13067	1	1487	7	27	6		
5月2日	5月3日	ND	ND	50	3	102	2	ND	670	2	1141	2	50	6	22477	1	1482	8	27	6		
5月3日	5月4日	ND	ND	47	3	89	2	ND	1885	1	1113	2	50	6	39892	1	1559	8	29	6		
5月4日	5月5日	ND	ND	46	5	94	3	ND	4598	2	1112	3	45	13	33001	1	947	24	27	13		
5月7日	5月8日	ND	ND	68	2	131	2	ND	1802	1	1103	2	51	6	15307	1	1419	8	31	6		
5月8日	5月9日	ND	ND	48	3	95	2	ND	4656	1	1106	2	48	7	60440	1	1462	8	31	6		
5月9日	5月10日	ND	ND	81	2	148	2	ND	6628	1	1191	2	48	7	97289	1	1503	9	29	7		
5月10日	5月11日	ND	ND	67	2	126	2	ND	5476	1	1143	2	46	7	107001	1	1366	10	31	7		
5月11日	5月12日	ND	ND	35	3	66	2	ND	6709	1	1121	2	47	6	27722	1	1535	8	25	7		
5月14日	5月15日	ND	ND	38	3	71	2	ND	6355	1	1126	2	52	6	49389	1	1420	8	26	7		
5月15日	5月16日	ND	ND	90	2	167	2	ND	5485	1	1110	2	50	6	70018	1	1296	9	30	7		
5月16日	5月17日	ND	ND	46	3	90	2	ND	6659	1	1344	2	57	5	20222	1	1698	7	32	6		
5月17日	5月18日	ND	ND	49	3	96	2	ND	3944	1	1126	2	54	6	83792	1	1435	9	30	7		
5月24日	5月25日	ND	ND	65	2	122	2	ND	4179	1	1142	2	53	6	43061	1	1497	8	28	7		
5月25日	5月26日	ND	ND	68	2	136	2	ND	2184	1	1138	2	54	6	92463	1	1616	8	27	8		
5月31日	6月1日	ND	ND	63	2	126	2	ND	5649	1	1141	2	54	6	49548	1	1708	7	25	8		
MDC最低値		4	6					12														
MDC最高値		10	14					27														
平均				57		111			4203		1142		50		51543		1464		28			
標準偏差				15		28			2175		58		4		30605		176		2			

注1): NDは“非検出”を表す。

注2): 核種の選定は、第3.3項の説明参照

注3): 5月5-7日、5月12-14日、5月18日-24日、5月26-31日の試料は、装置の不具合により解析データ(RRR)が発表されていない。

6月

大気捕集時刻		CTBT監視対象放射性核種							天然放射性核種													
		I-131		Te-132		Cs-134		Cs-137		Ba-140	Be-7		K-40		Ac-228		Pb-212		Pa-234m		Bi-214	
開始	終了	MDC	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ
		μBq/m ³	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)
6月1日	6月2日	ND	ND	63	2	126	2	ND	5504	1	1141	2	52	6	55400	1	1470	8	30	6		
6月2日	6月3日	ND	ND	50	3	98	2	ND	6643	1	1145	2	57	6	69825	1	1648	2	30	7		
6月4日	6月5日	ND	ND	89	2	175	2	ND	6857	1	1118	2	51	6	102616	1	1414	9	27	8		
6月6日	6月7日	ND	ND	106	2	213	1	ND	6535	1	1131	2	45	7	81134	1	1433	9	31	7		
6月8日	6月9日	ND	ND	167	2	333	1	ND	9370	1	1115	2	58	6	63157	1	1566	8	22	9		
6月12日	6月13日	ND	ND	32	4	61	2	ND	1877	1	1100	2	49	6	34800	1	1425	8	27	7		
6月15日	6月16日	ND	ND	26	4	54	2	ND	7350	1	1121	2	53	6	15534	1	1420	8	31	6		
6月16日	6月17日	ND	ND	63	2	124	2	ND	4189	1	1138	2	44	7	24116	1	1440	8	31	6		
6月17日	6月18日	ND	ND	46	3	91	2	ND	4361	1	1150	2	52	6	54687	1	1266	10	26	7		
6月18日	6月19日	ND	ND	53	3	106	2	ND	6106	1	1310	2	50	6	46454	1	1475	9	32	6		
6月21日	6月22日	ND	ND	33	3	71	2	ND	4337	1	1119	2	51	6	28854	1	1525	8	28	7		
6月26日	6月27日	ND	ND	30	4	58	2	ND	6015	1	1156	2	49	6	11676	1	1287	9	26	7		
6月27日	6月28日	ND	ND	38	3	75	2	ND	5031	1	1361	2	51	6	25088	1	1537	8	28	7		
6月28日	6月29日	ND	ND	30	4	63	2	ND	4145	1	1102	2	51	6	36315	1	1515	8	26	7		
6月29日	6月30日	ND	ND	29	4	59	2	ND	3763	1	1142	2	49	6	37349	1	1440	8	24	8		
6月30日	7月1日	ND	ND	34	3	73	2	ND	4105	1	1074	2	51	6	33113	1	1224	10	25	8		
MDC最低値		5	6					12														
MDC最高値		7	9					18														
平均				56		111			5387		1151		51		45007		1443		28			
標準偏差				37		74			1781		76		3		24801		111		3			

注1): NDは“非検出”を表す。

注2): 核種の選定は、第3.3項の説明参照

注3): 6月3-4日、5-6日、7-8日、9-12日、13-15日、19-20日、22-26日の試料は、装置の不具合により解析データ (RRR) が発表されていない。

7月

大気捕集時刻		CTBT監視対象放射性核種								天然放射性核種												
		I-131		Te-132		Cs-134		Cs-137		Ba-140	Be-7		K-40		Ac-228		Pb-212		Pa-234m		Bi-214	
開始	終了	MDC	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	MDC	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ	濃度	不確かさ
		μBq/m ³	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)	μBq/m ³	u (%)
7月3日	7月4日	ND	ND	31	4	59	2	ND	3906	1	1113	2	50	6	52380	1	1478	8	30	7		
7月4日	7月5日	ND	ND	76	2	151	2	ND	2290	1	1316	2	51	7	71597	1	1757	8	32	7		
7月5日	7月6日	ND	ND	32	4	71	2	ND	1477	1	1342	2	60	6	64345	1	1771	8	29	7		
7月6日	7月7日	ND	ND	38	3	74	2	ND	1667	1	1322	2	53	6	65921	1	1510	9	29	7		
7月9日	7月10日	ND	ND	39	3	83	2	ND	2285	1	1120	2	48	6	39635	1	1421	8	29	7		
7月10日	7月11日	ND	ND	36	3	75	2	ND	2181	1	1125	2	46	7	59260	1	1583	8	31	7		
7月11日	7月12日	ND	ND	36	3	77	2	ND	2650	1	1120	2	46	7	72625	1	1693	8	29	7		
7月12日	7月13日	ND	ND	31	4	70	2	ND	3682	1	1094	2	50	6	55727	1	1506	8	26	7		
7月13日	7月14日	ND	ND	42	3	80	2	ND	3614	1	1119	2	50	6	53973	1	1438	8	26	7		
7月14日	7月15日	ND	ND	36	3	74	2	ND	3144	1	1083	2	49	6	27555	1	1537	8	26	7		
7月15日	7月16日	ND	ND	46	3	92	2	ND	4325	1	1110	2	51	6	39463	1	1457	8	30	6		
7月18日	7月19日	ND	ND	33	3	73	2	ND	3936	1	1148	2	52	6	14781	1	1657	7	24	8		
7月19日	7月20日	ND	ND	41	3	84	2	ND	2260	1	1102	2	54	6	44661	1	1311	9	29	7		
7月20日	7月21日	ND	ND	42	3	83	2	ND	4010	1	1108	2	48	7	53024	1	1308	9	30	7		
7月21日	7月22日	ND	ND	64	2	126	2	ND	3596	1	1110	2	51	6	67481	1	1561	8	29	7		
7月24日	7月25日	ND	ND	31	4	63	2	ND	582	2	1086	2	49	6	22477	1	1337	8	26	7		
7月25日	7月26日	ND	ND	34	3	70	2	ND	1603	1	1137	2	48	6	34947	1	1525	8	29	7		
7月26日	7月27日	ND	ND	31	4	64	2	ND	4994	1	1131	2	48	6	28617	1	1419	8	30	6		
7月28日	7月29日	ND	ND	38	4	74	2	ND	2775	1	1130	2	46	8	24855	1	1708	9				
7月29日	7月30日	ND	ND	42	3	86	2	ND	1485	1	1170	2	55	6	36118	1	1513	8	29	7		
7月30日	7月31日	ND	ND	38	3	78	2	ND	2754	1	1150	2	51	6	30032	1	1438	8	31	6		
MDC最低値		5	6					12														
MDC最高値		7	9					20														
平均				40		81			2820		1149		50		45689		1520		29			
標準偏差				11		21			1132		77		3		17547		136		2			

注1): NDは“非検出”を表す。

注2): 核種の選定は、第3.3項の説明参照

注3): 7月1-3日、7-9日、16-18日、22-24日、27-28日の試料は、装置の不具合により解析データ (RRR) が発表されていない。

8月

大気捕集時刻		CTBT監視対象放射性核種								天然放射性核種												
		I-131		Te-132		Cs-134		Cs-137		Ba-140	Be-7		K-40		Ac-228		Pb-212		Pa-234m		Bi-214	
開始	終了	MDC μBq/m ³	MDC μBq/m ³	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	MDC μBq/m ³	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)	濃度 μBq/m ³	不確かさ u (%)
8月3日	8月4日	ND	ND	30	4	58	2	ND	2600	1	1121	2	48	6	36374	1	1413	8	26	7		
8月6日	8月7日	ND	ND	27	4	57	2	ND	2853	1	1151	2	52	6	27298	1	1407	8	32	6		
8月7日	8月8日	ND	ND	43	3	99	2	ND	5920	1	1109	2	51	6	41003	1	1506	8	33	6		
8月8日	8月9日	ND	ND	35	3	70	2	ND	4774	1	1131	2	52	6	57988	1	1634	8	30	7		
8月9日	8月10日	ND	ND	41	3	82	2	ND	3103	1	1121	2	53	6	59079	1	1429	9	31	6		
8月10日	8月11日	ND	ND	33	3	68	2	ND	2274	1	1113	2	49	6	42688	1	1370	9	33	6		
8月11日	8月12日	ND	ND	34	3	75	2	ND	3938	1	1113	2	51	6	43316	1	1445	8	26	8		
8月12日	8月13日	ND	ND	46	3	93	2	ND	4584	1	1136	2	47	6	38244	1	1428	8	36	5		
8月13日	8月14日	ND	ND	53	3	113	2	ND	5622	1	1150	2	48	7	50078	1	1367	9	33	6		
8月14日	8月15日	ND	ND	45	3	97	2	ND	5643	1	1160	2	43	7	79724	1	1417	9	30	7		
8月15日	8月16日	ND	ND	35	3	72	2	ND	5809	1	1139	2	49	6	71657	1	1577	8	28	7		
8月16日	8月17日	ND	ND	43	3	88	2	ND	5159	1	1103	2	45	7	41105	1	1325	9	28	7		
8月17日	8月18日	ND	ND	44	3	92	2	ND	5269	1	1148	2	51	6	67726	1	1434	9	27	7		
8月18日	8月19日	ND	ND	31	4	60	2	ND	5542	1	1128	2	51	6	67844	1	1468	9	29	7		
8月19日	8月20日	ND	ND	35	3	72	2	ND	5258	1	1093	2	46	7	68017	1	1326	9	28	7		
8月20日	8月21日	ND	ND	46	3	102	2	ND	2159	1	1134	2	49	6	41621	1	1463	8	33	6		
8月21日	8月22日	ND	ND	37	3	79	2	ND	2013	1	1097	2	48	6	25311	1	1536	8	26	7		
8月22日	8月23日	ND	ND	33	4	72	2	ND	2965	1	1110	2	51	6	52070	1	1475	8	28	7		
8月23日	8月24日	ND	ND	30	4	68	2	ND	1411	1	1119	2	50	6	17410	1	1317	9	27	7		
8月24日	8月25日	ND	ND	68	2	144	2	ND	5849	1	1120	2	51	6	30757	1	1563	8	31	6		
8月25日	8月26日	ND	ND	44	3	97	2	ND	5152	1	1156	2	55	6	24875	1	1523	8	25	7		
8月26日	8月27日	ND	ND	31	3	64	2	ND	4502	1	1067	2	52	6	20621	1	1481	8	28	7		
8月27日	8月28日	ND	ND	42	3	92	2	ND	4772	1	1127	2	52	6	16448	1	1418	8	32	6		
8月28日	8月29日	ND	ND	37	3	79	2	ND	4542	1	1162	2	52	6	55413	1	1332	9	30	6		
8月29日	8月30日	ND	ND	100	2	209	1	ND	5198	1	1144	2	49	6	54942	1	1517	8	27	7		
8月30日	8月31日	ND	ND	49	3	111	2	ND	1190	2	1127	2	53	6	31270	1	1484	8	29	7		
8月31日	9月1日	ND	ND	45	3	96	2	ND	971	2	1139	2	48	6	43970	1	1467	8	33	6		
MDC最低値		4	6					13														
MDC最高値		6	9					17														
平均				42		89			4040		1127		50		44698		1449		29			
標準偏差				14		31			1601		22		3		17510		81		3			

注1): NDは“非検出”を表す。

注2): 核種の選定は、第3.3項の説明参照

注3): 8月1-3日、4-6日の試料は、装置の不具合により解析データ (RRR) が発表されていない。